

WOJEWÓDZKI SZPIĆAL PODKARPAC
im. Jana Pawła II w Krosnie
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAPATRZENIA
tel./fax 013 43 78 215, 013 43 78 497
NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 29.08.2017 roku

www.krosno.med.pl
do wszystkich uczestników postępowania

**Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
– nr postępowania EZ/215/70/2017**

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. SYSTEM DO CHŁODZENIA GŁOWY Z OPCJĄ CHŁODZENIA CAŁEGO CIAŁA DLA NOWORODKÓW. Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym termoregulacja noworodka jest realizowana poprzez jednorazowe, jednoczęściowe okrycia pacjenta, okrywające ok. 85% powierzchni ciała noworodka, w tym głowę?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. SYSTEM DO CHŁODZENIA GŁOWY Z OPCJĄ CHŁODZENIA CAŁEGO CIAŁA DLA NOWORODKÓW Punkt 4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem nastawienia temperatury ciała noworodka w zakresie od 32°C do 38°C?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. SYSTEM DO CHŁODZENIA GŁOWY Z OPCJĄ CHŁODZENIA CAŁEGO CIAŁA DLA NOWORODKÓW Punkt 5. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem kontroli temperatury ciała noworodka w zakresie od 15°C do 44°C?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. SYSTEM DO CHŁODZENIA GŁOWY Z OPCJĄ CHŁODZENIA CAŁEGO CIAŁA DLA NOWORODKÓW Punkt 9. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym w przypadku braku zasilania następuje wyłączenie systemu i przerwanie procedury termoregulacji oraz wyposażone w alarm braku wody lub zablokowania przepływu wody?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. SYSTEM DO CHŁODZENIA GŁOWY Z OPCJĄ CHŁODZENIA CAŁEGO CIAŁA DLA NOWORODKÓW Punkt 10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie do regulacji temperatury głębokiej pacjenta, kontrolowanej i korygowanej na zasadzie „sprzężenia zwrotnego” za pomocą rektalnego czujnika temperatury, wyposażonego w tryby pracy: chłodzenie (tryb noworodkowy lub dla dorosłych), normotermia, kontrolowane ogrzewanie po hipotermii, stand-by?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. SYSTEM DO CHŁODZENIA GŁOWY Z OPCJĄ CHŁODZENIA CAŁEGO CIAŁA DLA NOWORODKÓW Punkt 10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie łatwe do dezynfekowania, w którym płynem cyrkulacyjnym jest woda?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 7. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. SYSTEM DO CHŁODZENIA GŁOWY Z OPCJĄ CHŁODZENIA CAŁEGO CIAŁA DLA NOWORODKÓW Punkt 11. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 260 mm x 625 mm x 640 mm (z uchwytem 940 mm)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. SYSTEM DO CHŁODZENIA GŁOWY Z OPCJĄ CHŁODZENIA CAŁEGO CIAŁA DLA NOWORODKÓW Punkt 12. Czy Zamawiający dopuści mobilne urządzenie wyposażone w cztery koła (dwa z hamulcami) o wadze netto 34 kg?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 9. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. SYSTEM DO CHŁODZENIA GŁOWY Z OPCJĄ CHŁODZENIA CAŁEGO CIAŁA DLA NOWORODKÓW Punkt 15. Czy Zamawiający wymaga aby parametry i przeznaczenie urządzenia nie ograniczały jego stosowania do pacjentów o wadze do 50 kg, a pozwalały na jego użytkowanie niezależnie od wagi pacjenta?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 10. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. SYSTEM DO CHŁODZENIA GŁOWY Z OPCJĄ CHŁODZENIA CAŁEGO CIAŁA DLA NOWORODKÓW Punkt 17. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym przebieg procedury można zapisywać na zewnętrznym nośniku pamięci flash o pojemności 2 MB, połączonym z urządzeniem za pomocą portu RS232?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. SYSTEM DO CHŁODZENIA GŁOWY Z OPCJĄ CHŁODZENIA CAŁEGO CIAŁA DLA NOWORODKÓW Punkt 18. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w alarmy: niskiej temperatury, wysokiej temperatury, usterki systemu, braku wody, braku przepływu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. SYSTEM DO CHŁODZENIA GŁOWY Z OPCJĄ CHŁODZENIA CAŁEGO CIAŁA DLA NOWORODKÓW. Czy Zamawiający wymaga aby czynnikiem chłodzącym/grzejącym była woda sterylna lub woda wodociągowa filtrowana filtrem 0,22 μ a stosowanie urządzenia nie wymagało stosowanie specjalnego dedykowanego płynu i zestawu do napełniania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. SYSTEM DO CHŁODZENIA GŁOWY Z OPCJĄ CHŁODZENIA CAŁEGO CIAŁA DLA NOWORODKÓW. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby urządzenie posiadało tryb kontrolowanego automatycznego ogrzewania po hipotermii, dzięki któremu urządzenie w sposób w pełni automatyczny ogrzewa pacjenta do określonej przez użytkownika temperatury terapeutycznej z zadaną prędkością od 0,05 °C do 0,5 °C na godzinę, bez konieczności manualnej zmiany pośrednich temperatur?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. SYSTEM DO CHŁODZENIA GŁOWY Z OPCJĄ CHŁODZENIA CAŁEGO CIAŁA DLA NOWORODKÓW. Czy Zamawiający będzie wymagał, aby komunikaty i informacje wyświetlane na ekranie były w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. MONITOR STOSOWANY W DIAGNOSTYCE URAZÓW MÓZGU. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie składające się z monitora parametrów życiowych o przekątnej ekranu 12,1”, zintegrowanego z urządzeniem do chłodzenia pacjenta, wyposażonego w moduł aEEG?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 16. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. MONITOR STOSOWANY W DIAGNOSTYCE URAZÓW MÓZGU. Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści moduł aEEG bez własnego zasilania?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 17. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. MONITOR STOSOWANY W DIAGNOSTYCE URAZÓW MÓZGU. Czy Zamawiający dopuści moduł aEEG o następujących parametrach, innych niż opisane w SIWZ:

wymiary: 140 x 95 x 30 mm

wyposażony w 5 gniazd do połączenia kabli elektrod, z możliwością stosowania różnych typów elektrod

impedancja wejściowa: >5 MΩ

maksymalny zakres na wejściu: ± 5.0 mV

szerokość pasma: 0,5 - 75 Hz

zakłócenia: < 10 nV / sqrt(Hz) przy 100 Hz

nie wymagający kalibracji

pomiar impedancji w oparciu o ocenę jakości linii

czułość: 0,1 μV

filtr niskich częstotliwości: 0,5 / 1,5 Hz

filtr wysokich częstotliwości: 15/35/50/70 Hz

baza czasu EEG: 15/30 mm/s definiowalna przez użytkownika

częstotliwość próbkowania: 640 Hz na kanał

interfejs komunikacyjny: port RS232

środowisko: temperatura 5 - 40°C, wilgotność 10 - 93%, nie skraplająca

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18. Pakiet nr 5 – zakup wraz z dostawą 1 szt. systemu do selektywnego chłodzenia głowy dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków. MONITOR STOSOWANY W DIAGNOSTYCE URAZÓW MÓZGU. Punkt 20. Czy Zamawiający dopuści komplet składający się z systemu do chłodzenia na podstawie jezdnej

(dwa koła z hamulcami), zamontowanego na nim monitora parametrów życiowych i modułu aEEG o maksymalnej wysokości 950 mm?


Odpowiedź: Nie.

Dodatkowo Zamawiający informuje Wykonawców, iż w zakresie pakietu nr 11 – meble medyczne wprowadza następujące wyjaśnienia:

Dotyczy pozycji a), b) oraz c) (Trakt porodowy Resuscytacja noworodków nr Sali 1C/28)

Zamawiający zmienia wysokość szafy lekarskiej dwudrzwiowej przeszklonej, szafy lekarskiej dwudrzwiowej bez szyb oraz szafy jednodrzwiowej przeszklonej ze 195 cm na 185 cm. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA W KARPACZKIEJ
Im. Jana Pawła II w Krośnie

mgr Piotr Czarwiński

*Pracownik
Krośno, dn. 7/14*




Projekt poradzony konsultacja nowo moduł w 10/28

3) Szafa jednokomorowa pełnowysoka (110x4)

4) Szafka niskopodłogowa (210x4)

5) Szafka stojąca szarykoma z blatem roboczym (210x4)

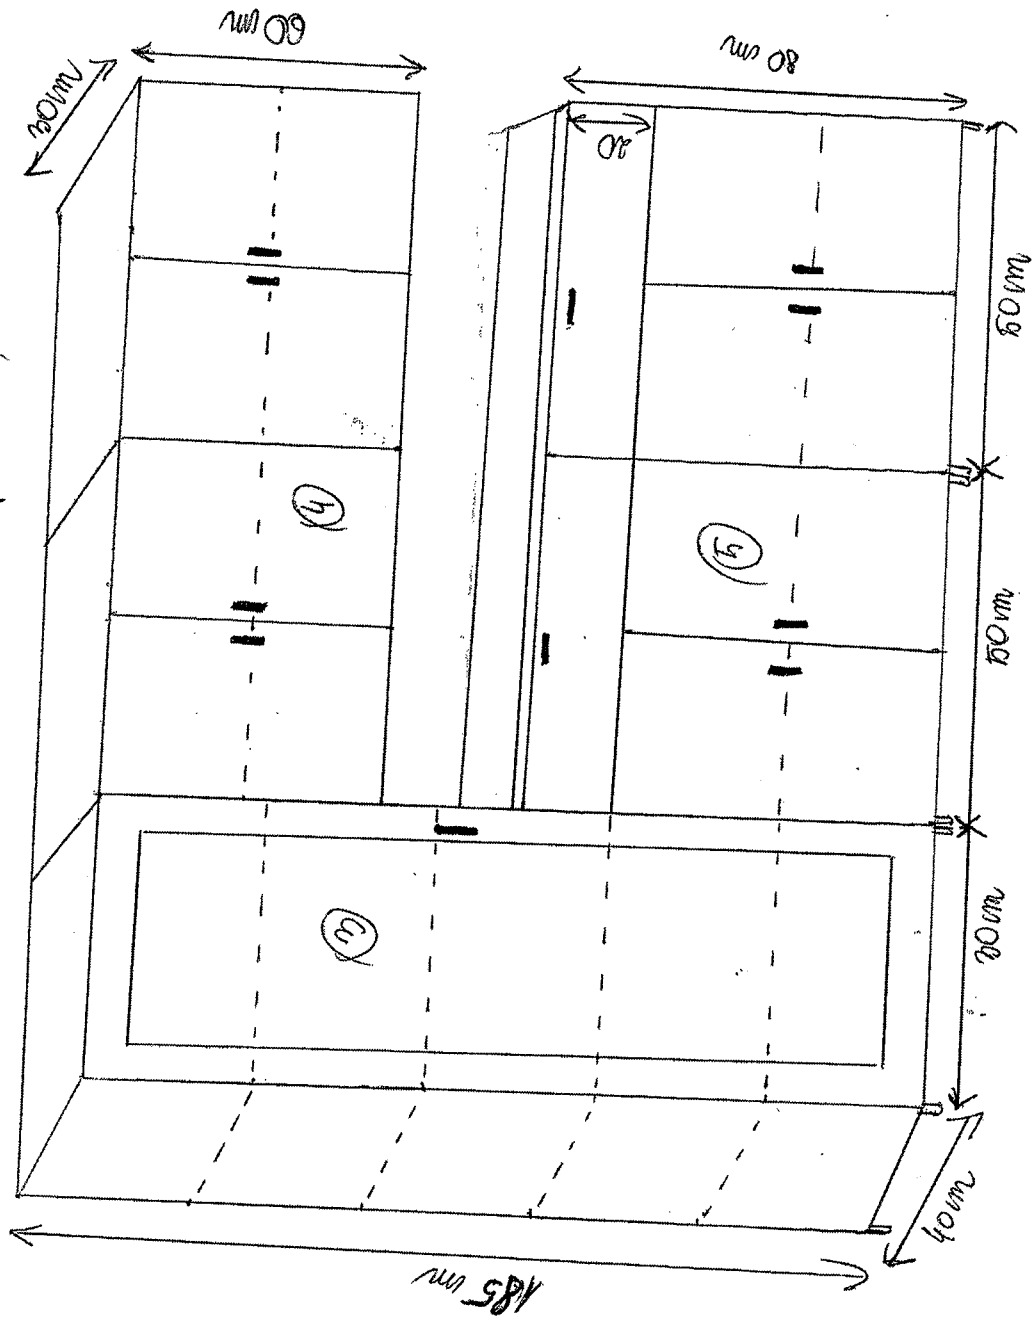

Wykonanie: Stelowne z zamkniętymi profilami aluminiowymi i X-izolacje ABS, emalowany lub lakierniczo powleczony ma kolorowej palety RAL, wypełnienie z płyty meblowej dwustronnie laminowanej.

3 i 5 - nożyki o wysokości 100 mm z maksymalną wytrzymałością

3) Front: drewno pniekowe boki pełne

Wyposażenie: 4x półka

4) Front - drewno pełne

Wyposażenie: 1x półka

5) Front: drewno pełne, blat pod blatem


Wyposażenie: 1x blat, 1x półka

Szafka i blat szarykoma ma kolor.

10/28



- Trakt porodowy sześciennej konstrukcji 1C/28
- 1) Siatka betonowa konstrukcyjna (10x10)
 - 2) Siatka betonowa konstrukcyjna (10x10)

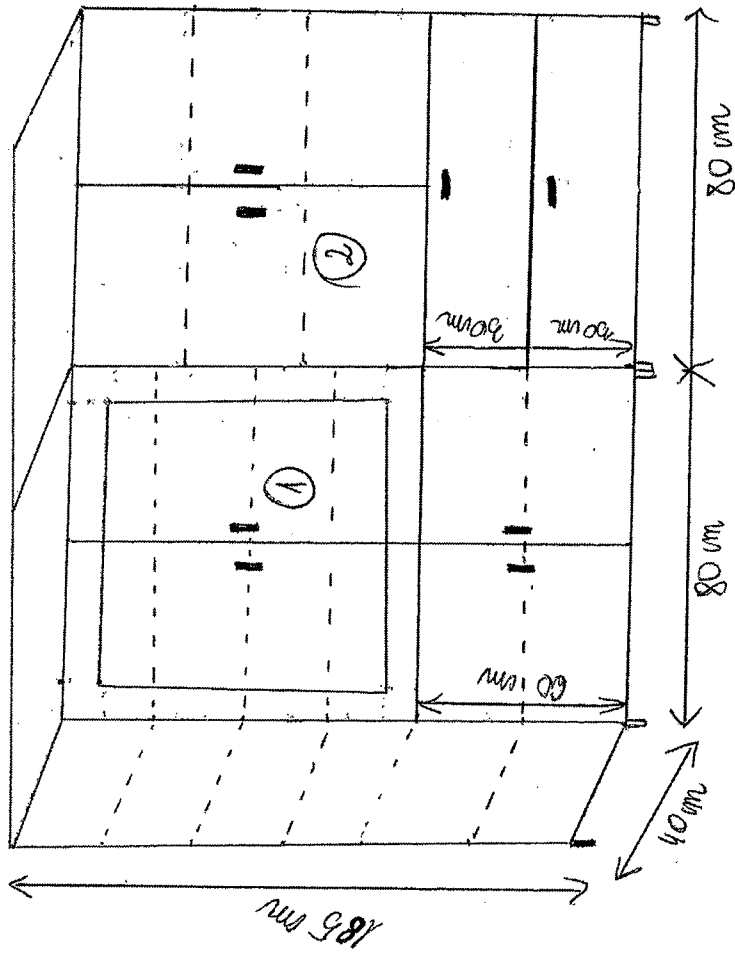

Wykonanie: Stalowa z zamkniętymi profilami aluminiowymi i węzłami ABS, smarowane lub lakierowane proszkowo ma kolor męej palety RAL, wypełnienie z piasku melonowej dławionnie laminowanej, może o wysokości 100 mm z możliwością wyposazowania

1) Dwie odne konstrukcje, dolne pełne, boki pełne
 Wyposazenie: górna siatka, dolna siatka

2) Front: drewni pełne
 Wyposazenie: dolna siatka, górna siatka

Siatki i siatki smarykone na tłuwe.

